



Внешний вид газоанализаторов АКВТ-01 с разметкой для монтажа

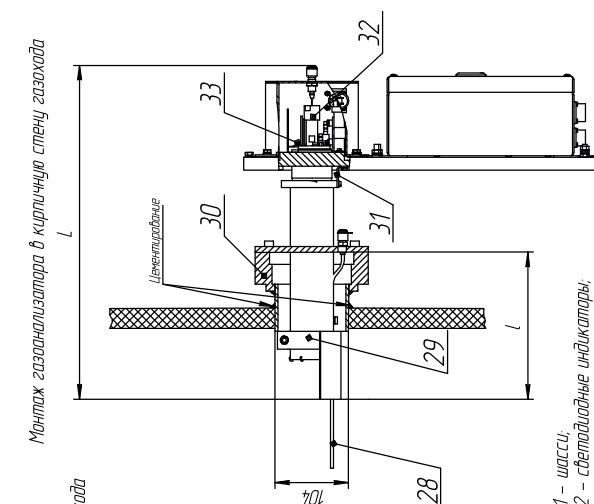

Монтаж газодиагностатора в кирпичную стену газопровода

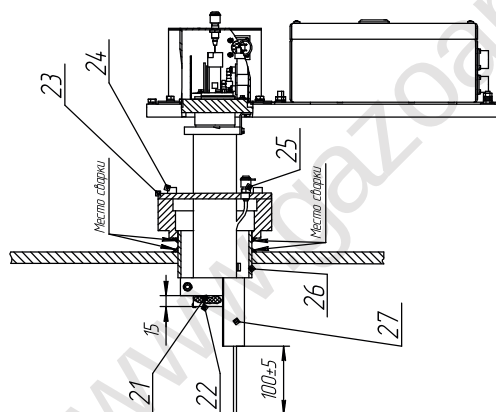

Монтаж газоанализатора в металлическую стену газохода



- 1 – шасси;
- 2 – светодиодные индикаторы;
- 3 – цифровой индикатор;
- 4 – кнопки управления режимами работы;

Обозначение	L, мм	l, мм
ИБЯ/Л4.134/5.003	446,5	200
-01	646,5	400
-02	1146,5	900
-03	1776,5	1530

- 20 – защитная панель;
- 21 – фильтр;
- 22 – проводка;
- 23 – фланец зонда;
- 24 – долт;
- 25 – штицер;
- 26 – трубка.


Цель	Конт.
A	1
B	2
OB	3
+1	4
-1	5
+2	6
-2	7

Цель	Конт
Рене1	1
Рене1	2
Рене2	3
Рене2	4

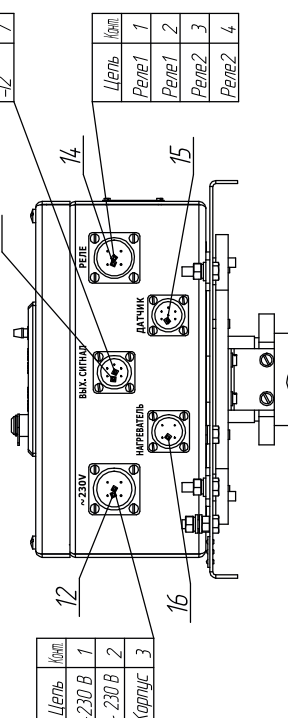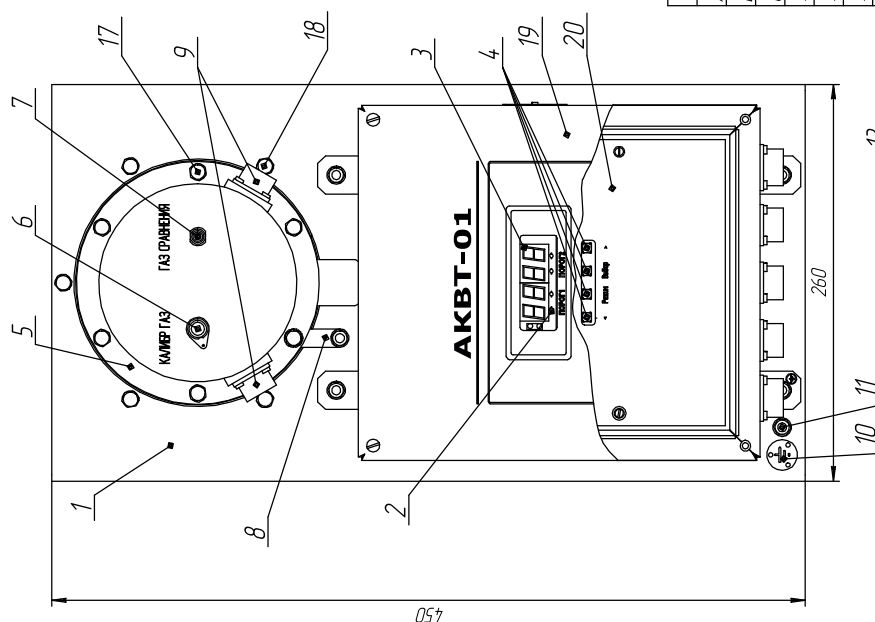


Цепь	Рекомендуемый тип провода (кабеля)	Обозначение документа на поставку
Подключение газонапайзаторов к сети переменного тока 230 В, 50 Гц	ПВС-У-3х0,75	ГОСТ 7399-97
Подключение внешних устройств сигнализации	ПВС-У-4х0,75	ГОСТ 7399-97
Подключение внешних устройств к токовому выходу газоанализатора	КММ-7х0,12 ШТЛ-7х0,12	ТУ 16.505.488-78 ТУ 16.505.268-76
Подключение внешних устройств по цифровому каналу связи RS 485	МКЭШВ 3х2х0,5	ТУ 16 К13-027-2001
Соединение ВРТО и зонда по цепи «НАГРЕВАТЕЛЬ»	ПВС-У-4х1,5	ГОСТ 7399-97
Соединение ВРТО и зонда по цепи «ПАТРУКИ»	КММ-4х0,12	ТУ 16.505.488-78


Внешний вид газоанализаторов АКВТ-02 с разметкой для монтажа

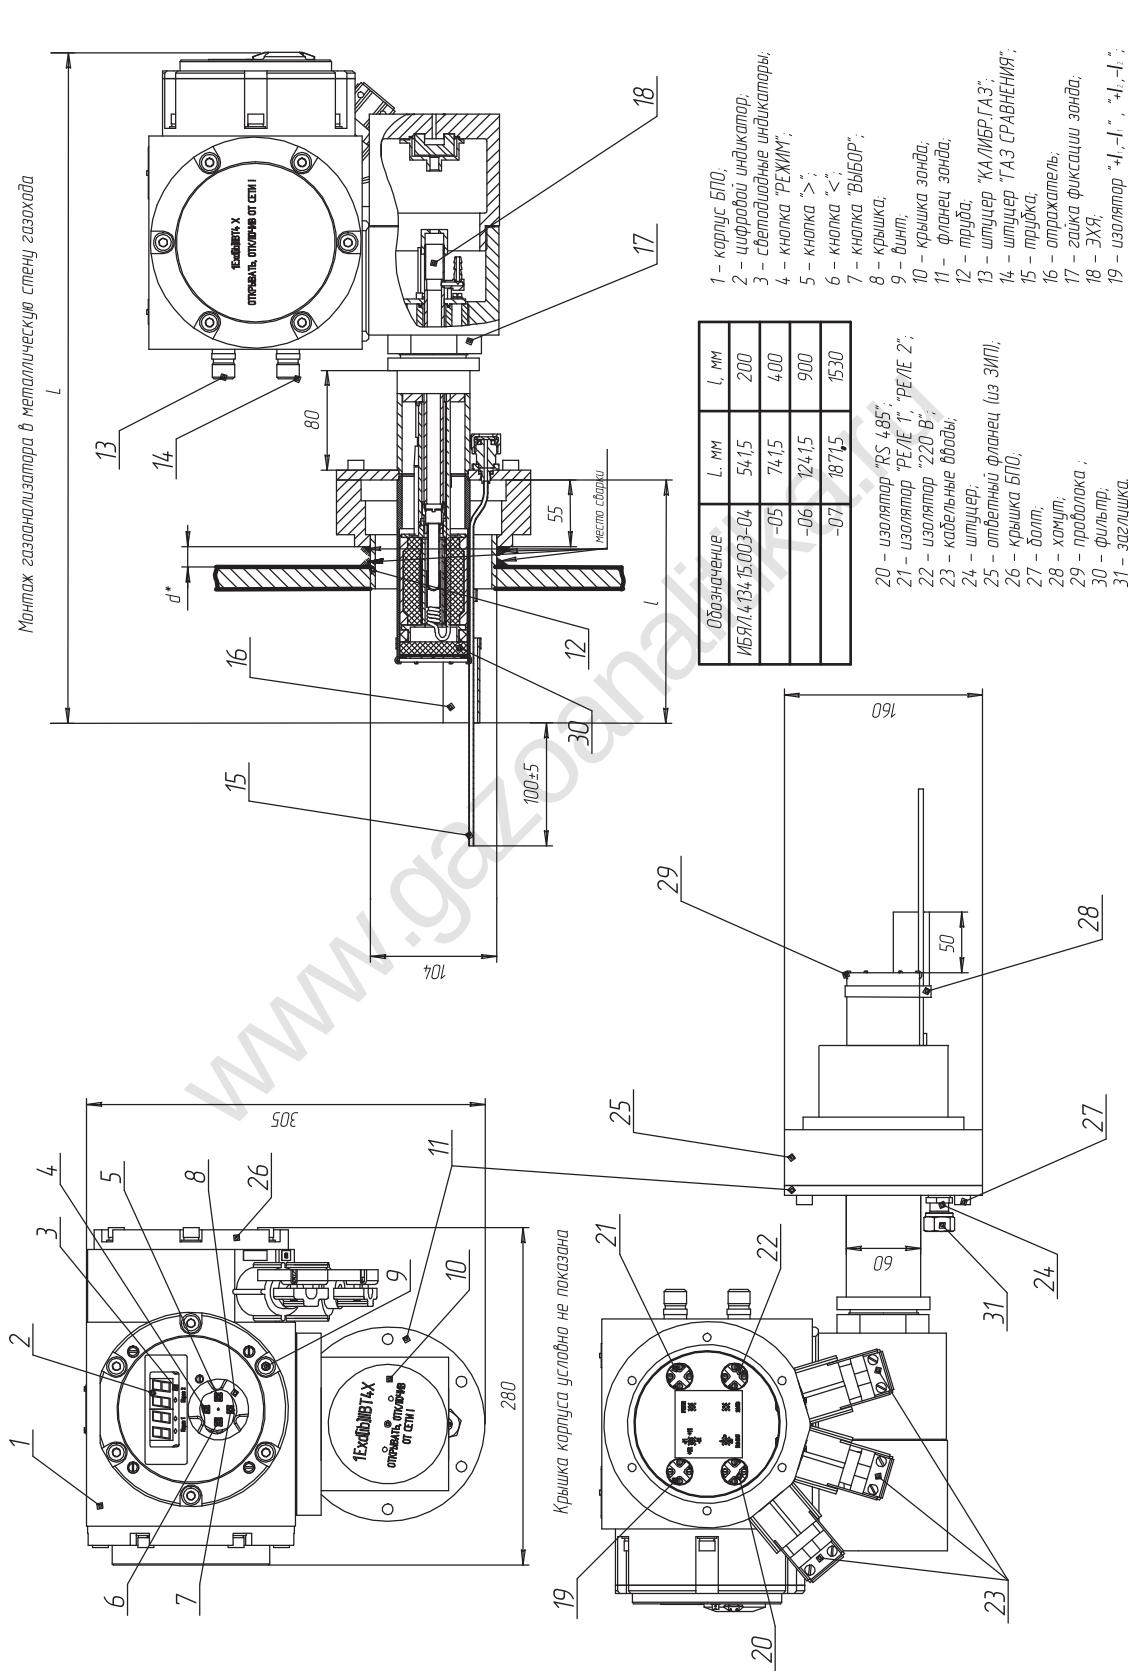

Крышка зонда условно не показана



Внешний вид газоанализаторов АКВТ-03 с разметкой для монтажа

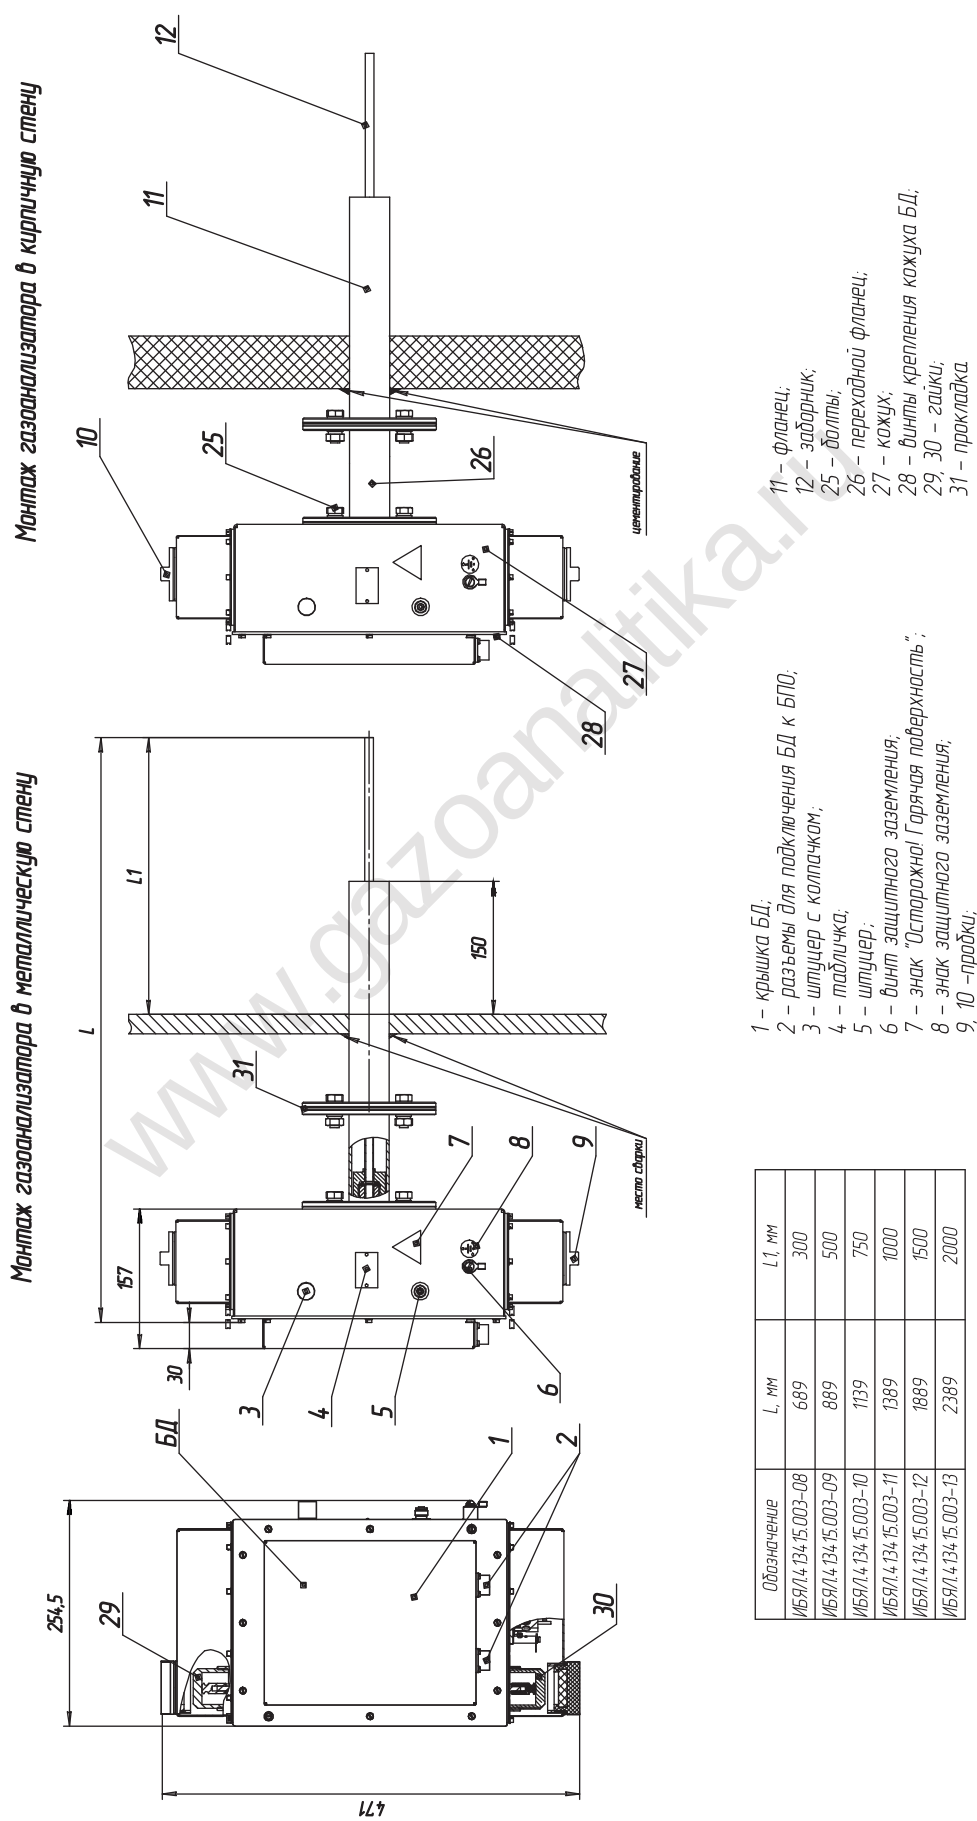

Обозначение	L, мм	L1, мм
ИБЯ/Л4.134.15.003-08	689	300
ИБЯ/Л4.134.15.003-09	889	500
ИБЯ/Л4.134.15.003-10	1139	750
ИБЯ/Л4.134.15.003-11	1389	1000
ИБЯ/Л4.134.15.003-12	1689	1500
ИБЯ/Л4.134.15.003-13	2389	2000

Газоанализаторы АКВТ-03. Блок питания и обработки

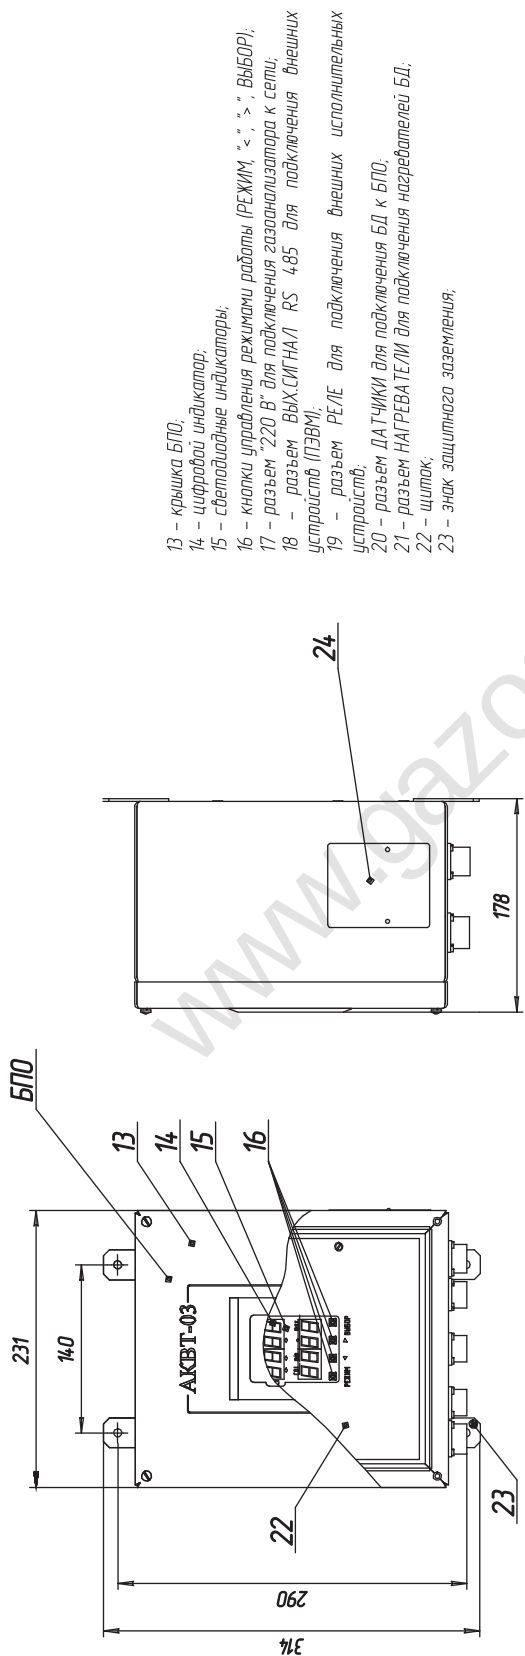


Схема электрическая соединений БПО с БД

